

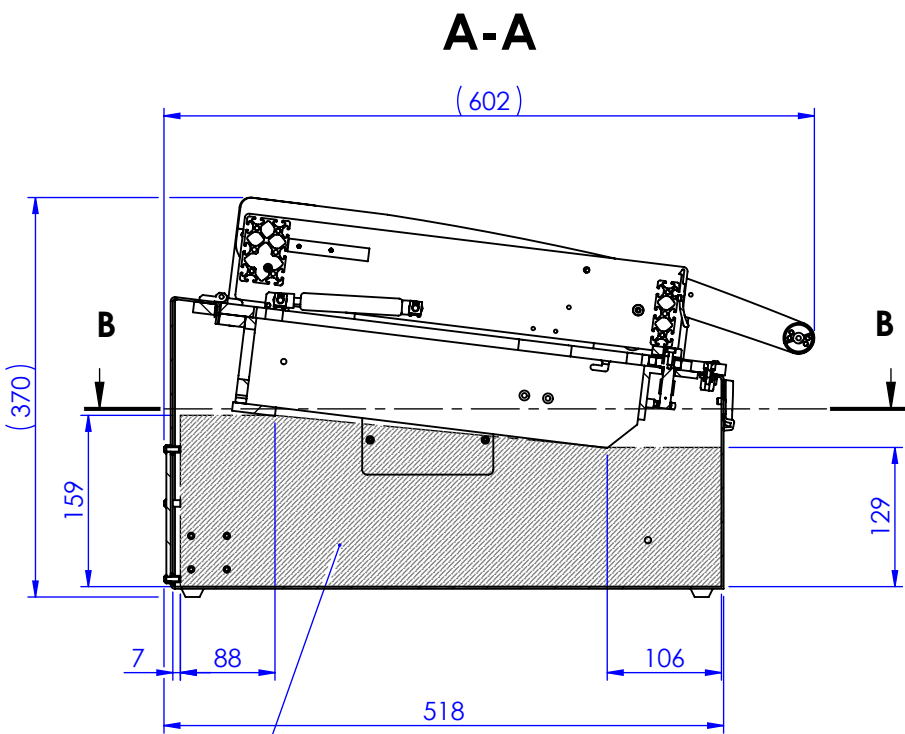
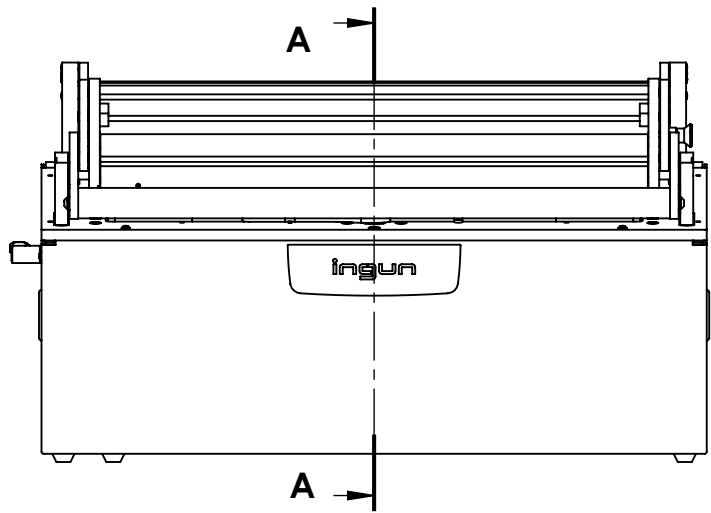
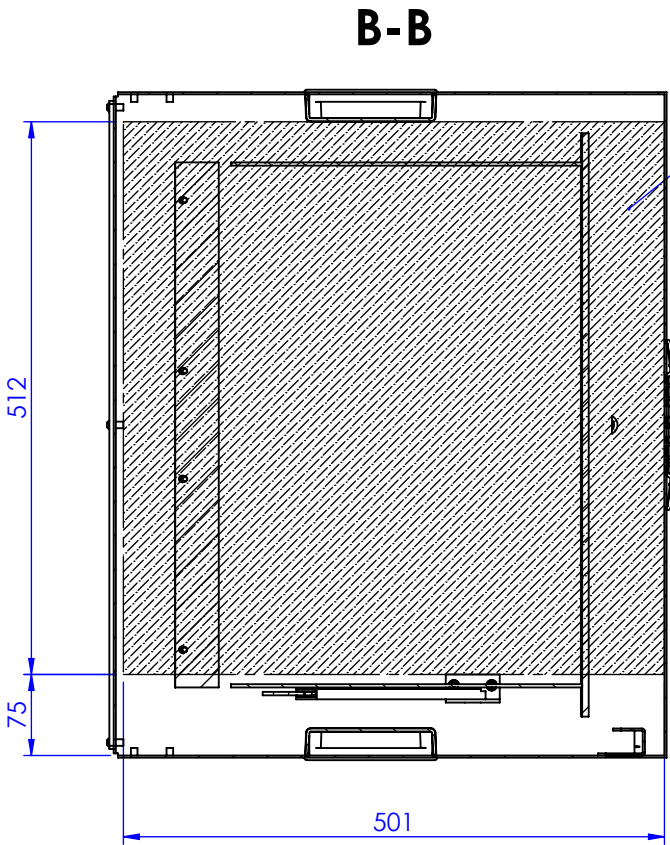


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.


Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

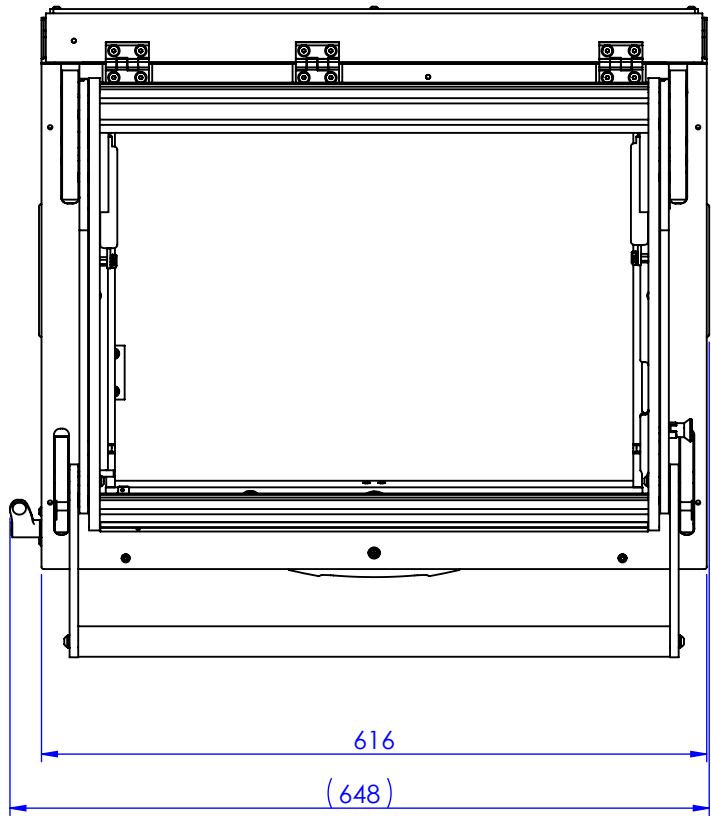

Empfohlener Platz für zusätzliche
Ausbauten z.B. Zusatzelektronik /
Recommended space for additional
components, e.g., additional electronics

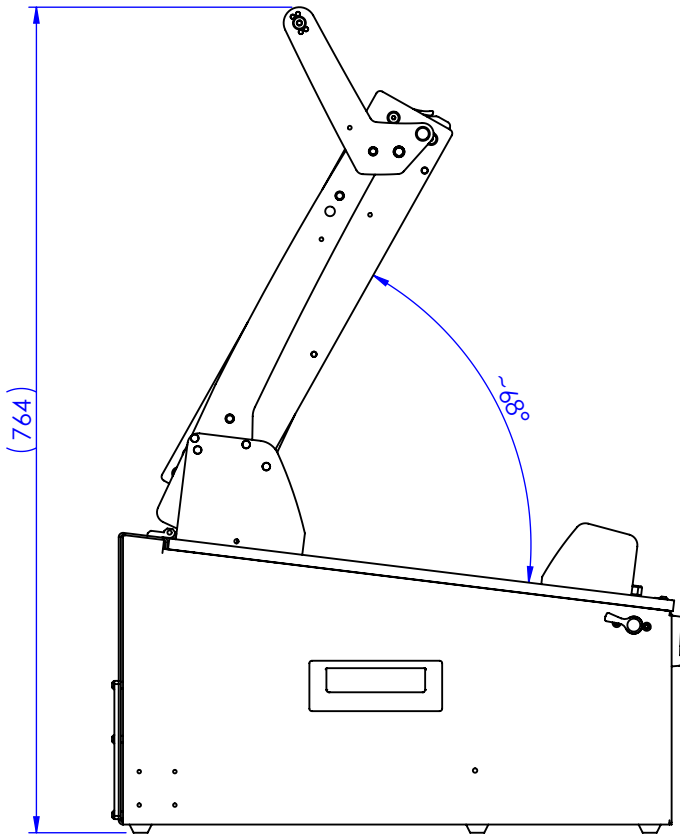

Empfohlener Platz für zusätzliche
Ausbauten z.B. Zusatzelektronik /
Recommended space for additional
components, e.g., additional electronics

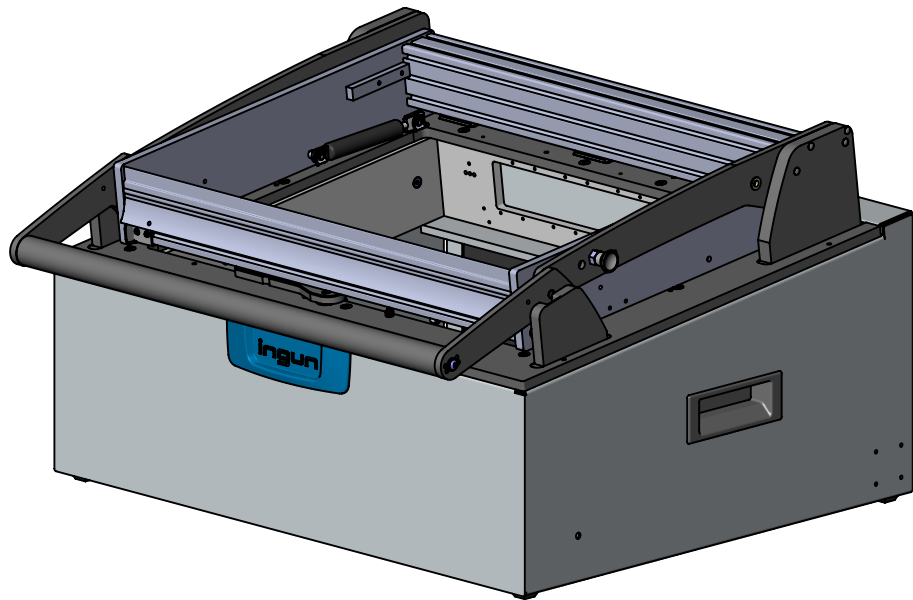

Maßstab/Scale:	1:7
gespeichert/saved:	16.11.2020 11:29:13
Montageanleitung/instruction sheet	



Benennung/Designation:	MA 3213/D/H/S-10/HG Manueller Prüfadapter MA 3213/D/H/S-10/HG manual test fixture
------------------------	--

Artikel-Nr./PartNo.:	49580
----------------------	-------

Index:	1
--------	---

Blatt/Sheet	1 von 1
DIN A3	